

グリコアルブミン 検査内容変更のお知らせ



2023年9月

株式会社グッドライフデザイン

この度、グリコアルブミンにおきまして、測定試薬・基準値設定根拠変更による検査内容変更が生じますのでご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

- 【項目名】 グリコアルブミン
- 【変更日時】 2023年10月1日（日）測定分より
- 【変更理由】 測定試薬の変更、基準値設定根拠の変更
- 【変更内容】 以下表の通り


	変更前	変更後
試薬名	ルシカ®GA-L 旭化成ファーマ株式会社	ルシカ®GA-L2 旭化成ファーマ株式会社
測定範囲	3.2～68.1 %	5.4～73.4 %
基準値 (設定根拠)	12.3～16.5 % (新しい酵素法によるグリコアルブミン測定試薬の評価)	11.0～16.0 % (日本糖尿病学会 糖尿病治療ガイド)

検査方法、必要検体量に変更はございません。

※1 同一メーカーが販売する改良試薬への切り替えとなります。新試薬は JCCRM611 - 1 (グリコアルブミン測定用常用参照標準物質) からのトレーサビリティが確保されたものとなります。

※2 以下、相関検討結果

新試薬

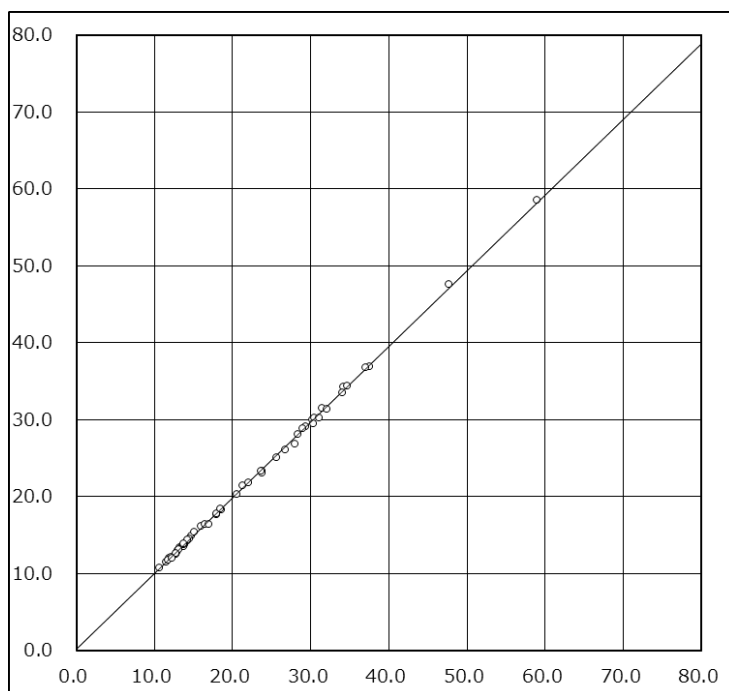

現行試薬

	結果
グリコアルブミン(%)	$y=0.9846x+0.07$ $r=0.9996$

【 その他 】

・ 検査結果について

測定試薬の変更はございますが、変更前後の測定値の差が軽微であることから同一項目として扱うため、検査結果の表示に変更はございません。

以上

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学/免疫部門