

血清β2-MG、ASLO

検査内容変更のお知らせ



2024年 12月
株式会社グッドライフデザイン

このたびβ2-MG、ASLOにおきまして、測定試薬検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。


何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

- 【項目名】血清β2-MG、ASLO
- 【変更日時】2025年1月6日（月）測定分より
- 【変更理由】測定試薬の変更
- 【変更内容】以下の通り

血清β2-MG	変更前	変更後
試薬名	スペリオールBMG-II PHC株式会社	BMG-ラテックスX1「生研」 デンカ株式会社
測定範囲	0.3~72.0 mg/L	0.2~80.0 mg/L
基準範囲 (設定根拠)	2.0 mg/L未満 (トヨタ記念病院基準値)	2.0 mg/L以下 (臨床検査法提要)


ASLO	変更前	変更後
試薬名	エルピアエースASO II PHC株式会社	ASO-ラテックスX1「生研」 デンカ株式会社
測定範囲	20~600 IU/mL	20~800 IU/mL
基準範囲 (設定根拠)	200 IU/mL未満 (トヨタ記念病院基準値)	160 IU/mL以下 (メーカー推奨基準値)

※1 血清 β2-MG、相関検討結果。

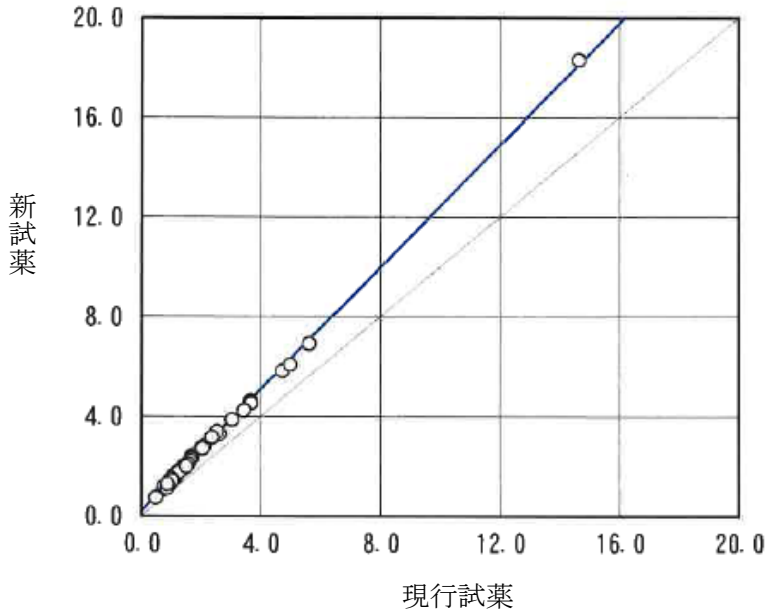

結果	
血清 β 2-MG (mg/L)	$y=1.2241x + 0.20$ $r=0.9995$

※2 ASLO、相関検討結果。

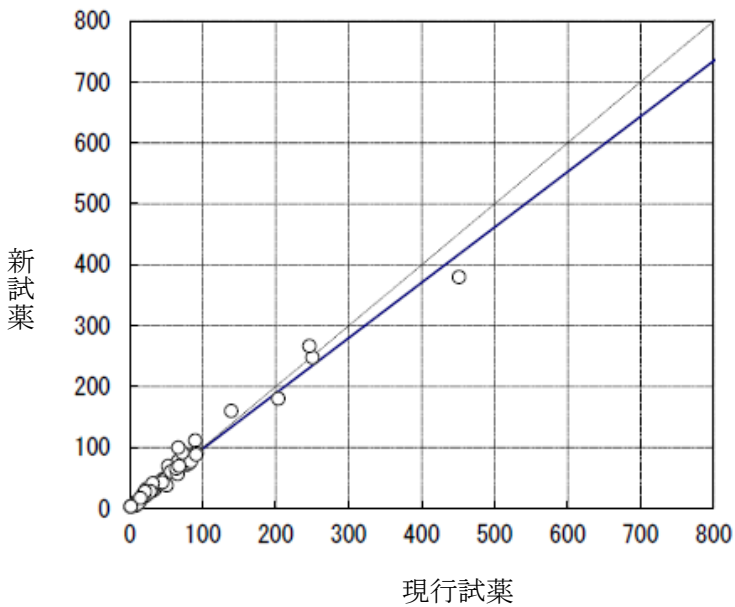

結果	
ASLO (IU/mL)	$y=0.909x + 7.3$ $r=0.9857$

【その他】

- ・検査方法、必要検体量に変更はございません。
- ・検査結果について、2項目共に新規項目の扱いとなるため、時系列が変更となります。
- ・血清β2-MGにおきまして上記の通り測定値の試薬間差を認め従来より測定値が高値となりますが、採用シェアの多い試薬への変更となるため、今後施設間の測定値の精確さの管理が可能となります。

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン

ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学/免疫

内線：6063